TK-SYSTEM

TK-System

TK-System è un sistema che preserva la biologia senza l'utilizzo di viti di serraggio e cementazione.

La sistematica protesica **TK-System** rappresenta una rivoluzionaria concezione di **protesizzazione** basata su una totale **ritenzione conometrica pura**, eliminando completamente la necessità di viti o cemento. Questo approccio apre la porta a una vasta gamma di soluzioni implantoprotesiche, offrendo flessibilità e versatilità senza precedenti.

È possibile protesizzare sia corone singole (grazie alla presenza di 3 indici di riposizionamento e cappette dedicate), sia protesi ad elementi multipli (grazie a cappette senza indici, cioè rotazionali).

Nel caso di protesizzazioni multiple (grazie all'utilizzo di parallellizzatori dedicati) è possibile inserire i pilastri con un perfetto parallelismo tra di loro, ed inoltre procedere direttamente in studio con la creazione di protesi provvisorie.

Questa tecnica si può utilizzare sia nella **versione analogica** (con l'utilizzo delle cappette di trasferimento **STP-SCAN-BODY**), che nell'impronta tradizionale per registrare con precisione la posizione degli abutment su un modello in gesso. È possibile, in alternativa, adottare la **tecnica digitale** utilizzando gli scanbody direttamente sugli abutment nel cavo orale effettuando una scansione intraorale per trasferire in modo digitale la loro posizione.

Abbreviazioni TK-System

TKAD	Abutment dritto - TK-System	*Pag. 47*
TKAA	Abutment angolato - TK-System	*Pag. 48*
TKSBT	STP-Peek - TK-System	*Pag. 49*
TKCCTA	Cappette coniche - Non rotante - TK-System	*Pag. 50*
TKCCTR	Cappette coniche - Rotante - TK-System	*Pag. 50*
TKAD	Analogo da laboratorio - TK-System	*Pag. 51*
TKRPAD	Rondella per analogo da laboratorio	*Pag. 51*
TKP	Parallelizzatore - TK-System	*Pag. 51*

Legenda

HT	Altezza transmucosa
HP	Altezza protesica
D (Ø)	Diametro
A	Antirotazionale
R	Rotazionale

Altezze protesiche e angolazioni

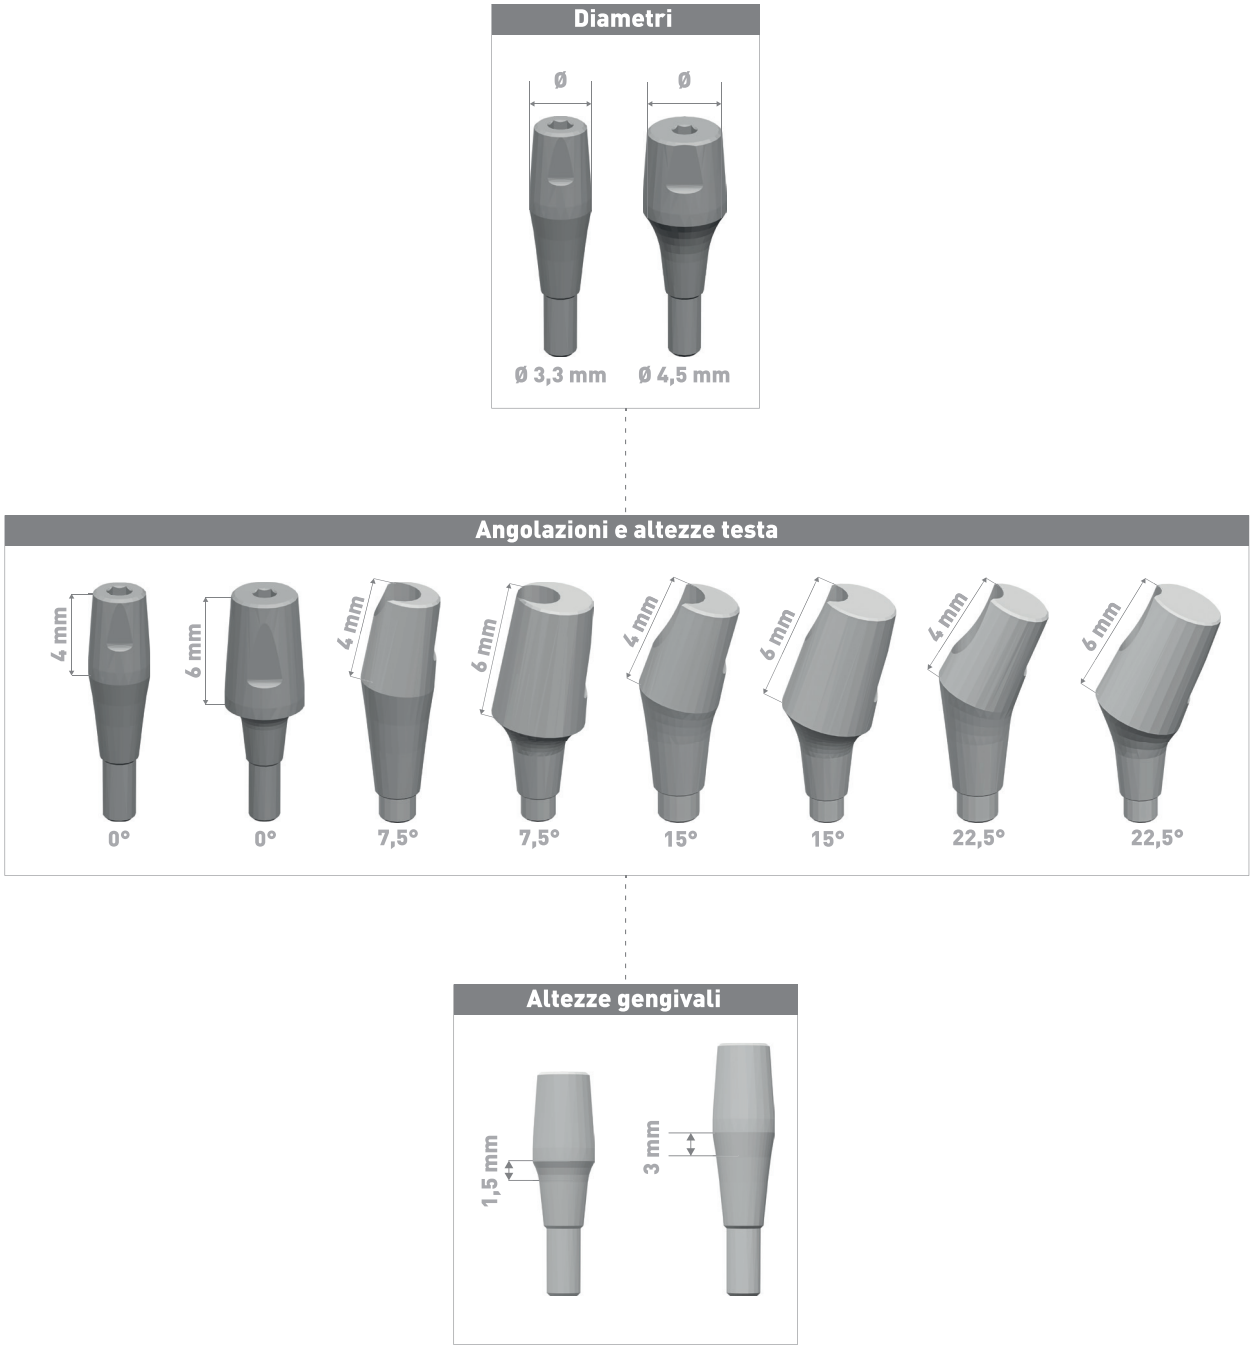

Abutment dritti TK-System

I monconi protesici **TK-System** dritti, vengono posizionati tramite l'apposito driver per le componenti con Ø 3.3 e il driver per le componenti con Ø 4.5.

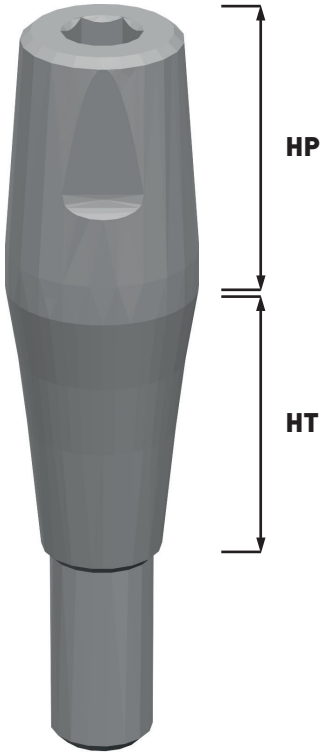

Descrizione	Codice
Abutment Dritto - HT 1,5 - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKAD150433
Abutment Dritto - HT 3 - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKAD030433
Abutment Dritto - HT 1,5 - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKAD150633
Abutment Dritto - HT 3 - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKAD030633
Abutment Dritto - HT 1,5 - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKAD150445
Abutment Dritto - HT 3 - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKAD030445
Abutment Dritto - HT 1,5 - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKAD150645
Abutment Dritto - HT 3 - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKAD030645

Raccomandazione: Tutte le viti protesiche devono essere serrate a non oltre 15 Newton.

Abutment angolati TK-System

Abutment angolati - TK-System - 7,5°

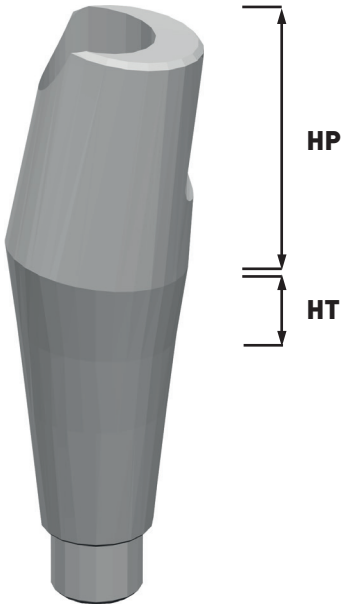

Descrizione	Codice
Abutment 7,5° - HT 1,5 - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKAA15043375
Abutment 7,5° - HT 3 - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKAA03043375
Abutment 7,5° - HT 1,5 - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKAA15063375
Abutment 7,5° - HT 3 - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKAA03063375
Abutment 7,5° - HT 1,5 - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKAA15044575
Abutment 7,5° - HT 3 - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKAA03044575
Abutment 7,5° - HT 1,5 - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKAA15064575
Abutment 7,5° - HT 3 - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKAA03064575

Abutment angolati - TK-System - 15°

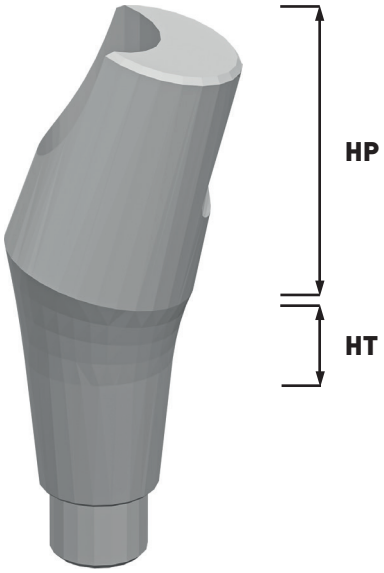

Descrizione	Codice
Abutment 15° - HT 1,5 - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKAA15043315
Abutment 15° - HT 3 - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKAA03043315
Abutment 15° - HT 1,5 - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKAA15063315
Abutment 15° - HT 3 - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKAA03063315
Abutment 15° - HT 1,5 - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKAA15044515
Abutment 15° - HT 3 - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKAA03044515
Abutment 15° - HT 1,5 - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKAA15064515
Abutment 15° - HT 3 - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKAA03064515

Tutti i monconi angolati TK-System vengono posizionati con l'apposito driver e la vite deve essere serrata non oltre 15 Newton.

Abutment angolati - TK-System - 22,5°

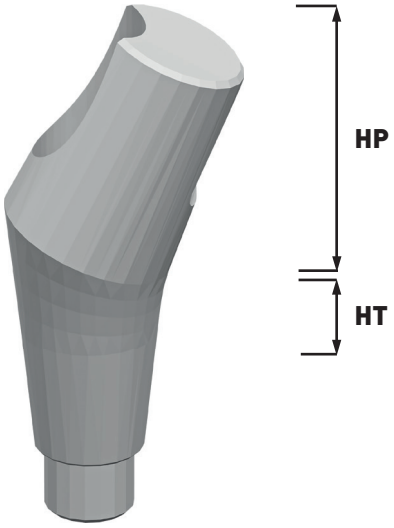

Descrizione	Codice
Abutment 22,5° - HT 1,5 - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKAA15043322
Abutment 22,5° - HT 3 - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKAA03043322
Abutment 22,5° - HT 1,5 - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKAA15063322
Abutment 22,5° - HT 3 - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKAA03063322
Abutment 22,5° - HT 1,5 - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKAA15044522
Abutment 22,5° - HT 3 - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKAA03044522
Abutment 22,5° - HT 1,5 - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKAA15064522
Abutment 22,5° - HT 3 - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKAA03064522

Tutti i monconi angolati TK-System vengono posizionati con l'apposito driver e la vite deve essere serrata non oltre 15 Newton.

STP-PEEK - TK-System

Scan body + Transfer da impronta + Cappetta di protezione

STP-PEEK - TK-System ha una tripla funzione:

- **Cappetta di riposizionamento**, tecnica a strappo per poter eseguire un'impronta analogica e riprodurre la posizione degli abutment in un modello in gesso.
- **Scan-body** per la tecnica digitale, sia intraorale che da laboratorio.
- **Cappetta di protezione** dell'abutment.

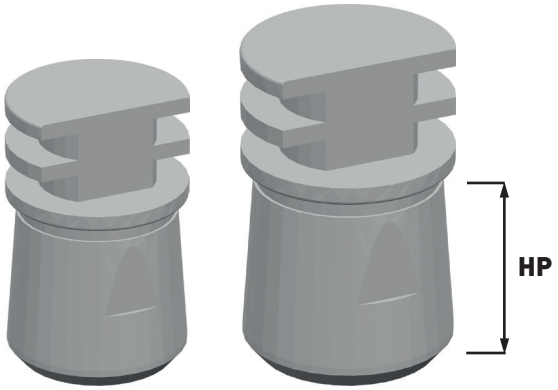

Descrizione	Codice
STP-PEEK - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKSBTC0433
STP-PEEK - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKSBTC0633
STP-PEEK - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKSBTC0445
STP-PEEK - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKSBTC0645

Cappette coniche TK-System

Cappetta conica - TK-System - Non rotante

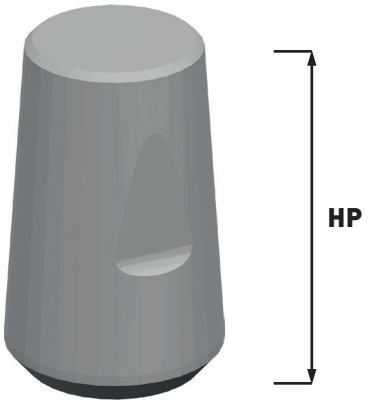

Descrizione	Codice
Cappetta conica - HP 4 - Ø 3,3 mm - Fissa	TKCCTA0433
Cappetta conica - HP 6 - Ø 3,3 mm - Fissa	TKCCTA0633
Cappetta conica - HP 4 - Ø 4,5 mm - Fissa	TKCCTA0445
Cappetta conica - HP 6 - Ø 4,5 mm - Fissa	TKCCTA0645

Cappetta conica - TK-System - Rotante

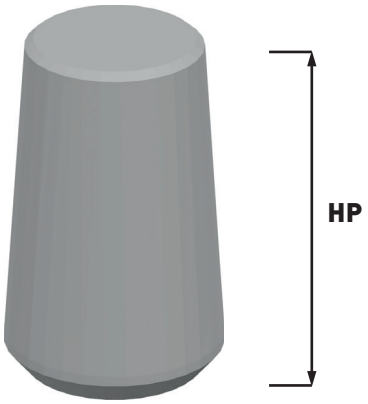

Descrizione	Codice
Cappetta conica - HP 4 - Ø 3,3 mm - Rotante	TKCCTR0433
Cappetta conica - HP 6 - Ø 3,3 mm - Rotante	TKCCTR0633
Cappetta conica - HP 4 - Ø 4,5 mm - Rotante	TKCCTR0445
Cappetta conica - HP 6 - Ø 4,5 mm - Rotante	TKCCTR0645

Raccomandazione: Tutte le viti protesiche devono essere serrate a non oltre 15 Newton.

Analogo da laboratorio TK-System

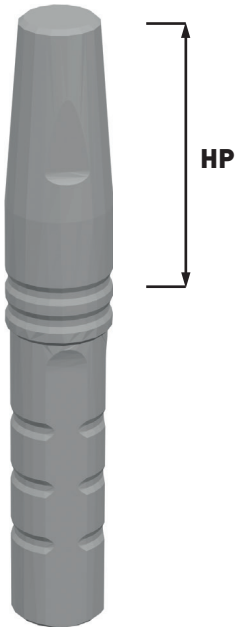

Descrizione	Codice
Analogo da laboratorio - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKAD0433
Analogo da laboratorio - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKAD0633
Analogo da laboratorio - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKAD0445
Analogo da laboratorio - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKAD0645

TKRPAD
Rondella per Analogo da laboratorio

Parallelizzatore TK-System

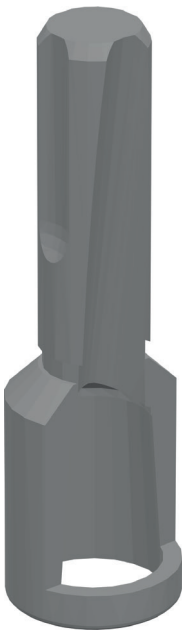

Descrizione	Codice
Parallelizzatore - HP 4 - Ø 3,3 mm	TKP0433
Parallelizzatore - HP 6 - Ø 3,3 mm	TKP0633
Parallelizzatore - HP 4 - Ø 4,5 mm	TKP0445
Parallelizzatore - HP 6 - Ø 4,5 mm	TKP0645

Raccomandazione: Tutte le viti protesiche devono essere serrate a non oltre 15 Newton.